

ご利用会員 各位

検査内容変更のお知らせ

平素は格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、当センターで実施しております HCV 抗体の検査試薬につきまして、現行試薬の販売中止に伴い、5月2日より、下記の通り、同一メーカーの改良試薬に変更致しますのでお知らせ申し上げます。

記

1. 検査測定試薬の変更


検査項目	変更箇所	新	旧
HCV 抗体	試薬	アボットジャパン(株)改良試薬	アボットジャパン(株)

※検査方法及び基準範囲に変更はございません。

2. 変更期日 令和4年5月2日(月) ご依頼分より

◆ご不明な点がございましたら下記までお問合せ下さい。◆
データインフォメーション室 電話 022-290-1500

(新旧二法の相関)

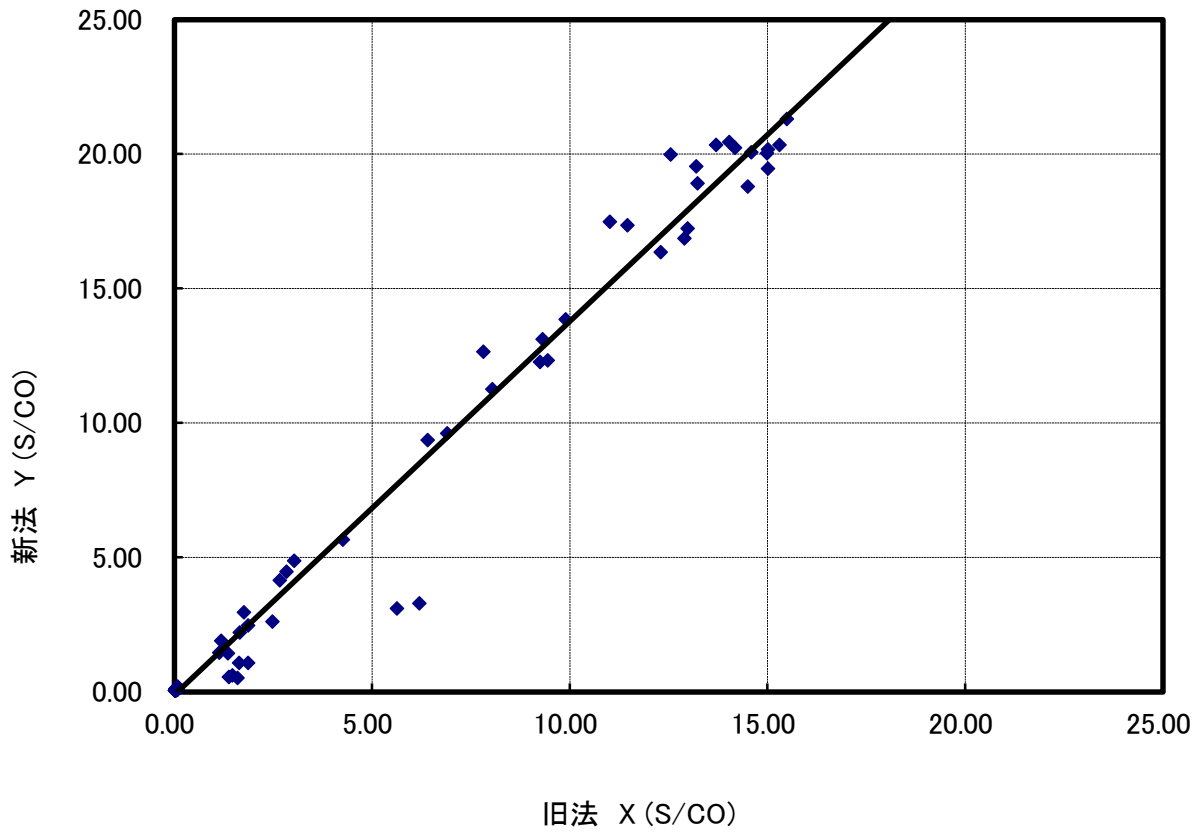

$$y(\text{新}) = 1.270x(\text{旧}) - 0.11$$
$$r = 0.993, n = 120$$

一致率 97%		旧試薬	
		(+)	(-)
新試薬	(+)	41	0
	(-)	3	56